TEST REPORT

委托单位：江西特斯汀环境检测有限公司

项目名称：[illegible]年度例行检测项目

样品类型：有组织废气

[illegible]

Jiangxi Testin Test Co.,Ltd

[redacted]

[redacted]

[redacted]

二、 依据

（1）GB/T16157-1996《

《固定污染源排气中颗粒物测定与气体污染物采样方法》

（2）HJ/T75-2017《

固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》

三、 标准

验收技术要求

检测项目	技术要求
气态污染物	排放浓度≥715mg/m³时，相对准确度≤15%
	143mg/m³≤排放浓度<715mg/m³时，绝对误差不超过±57mg/m³
	排放浓度<57mg/m³时，绝对误差不超过±17mg/m³
	排放浓度≥513mg/m³时，相对准确度≤15%
	143mg/m³≤排放浓度<513mg/m³时，相对误差不超过±25%
湿度CMS	湿度	烟气湿度≤5.0%时，绝对误差不超过±1.5%

CEMS 系统	FM-5	紫外差分吸收光谱	抚州泽天
颗粒物分析仪	FM-5	后散射法	抚州泽天
二氧化硫分析仪	FM-5	紫外差分吸收光谱	抚州泽天
氮氧化物分析仪	FM-5	紫外差分吸收光谱	抚州泽天
烟气流速	PT-500	差压法	抚州泽天
烟气温度			抚州泽天

项目	CEMS 数据均值	参比方法值	单位	比对监测结果	限值	结果评定	
二氧化硫	2[illegible]	20[illegible]	[illegible]	[illegible]		过±17mg/m³	
氮氧化物	168.028	146.3	mg/m³	22		过±41mg/m³	达标
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		过±10%	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		绝对误差不超过±3℃	达标
含氧量	10.951	10.9	%	0.47		相对准确度≤15%	达标
湿度	21.2[illegible]	21.33[illegible]	%	-0.33[illegible]		相对误差不超过±25%	达标
氯化氢	23.763	4.7	mg/m³	19		/	
一氧化碳	0.087	0.3	%	-0.21			

	第三次	15.247	7.0		第三次	0.005	0.0
(mg/m³)	第四次	31.914	3.3	氧化碳（%）	第四次	0.094	0.4
	第五次	10.145	3.4		第五次	0.108	1.0
	第六次	17.917	3.4		第六次	0.092	0.0
	平均值	23.763	4.7		平均值	0.087	0.3

续表：

	第一次	11.270	11.3
	第二次	9.680	10.0
	第三次	9.940	9.9

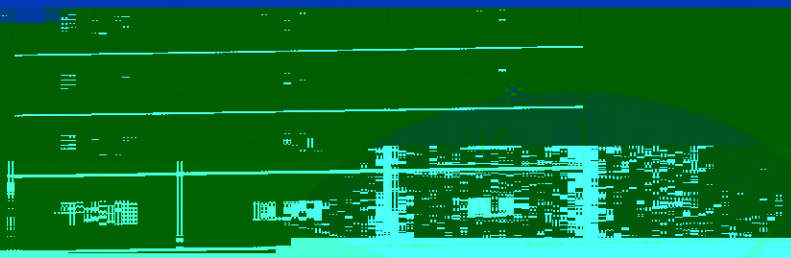

一氧化碳	烟尘（气）测试仪	ZR-3260D	JH		HJ/T 374-2007

报告结束***